




**1С:Лекторий**

27 сентября 2019 г.

# **Поддержка системы маркировки и прослеживания движения лекарственных препаратов в решениях 1С**

**Поддержка цифровой маркировки  
лекарственных средств в решениях  
фирмы «1С»: принципы реализации  
и подходы к автоматизации  
предприятий отрасли**



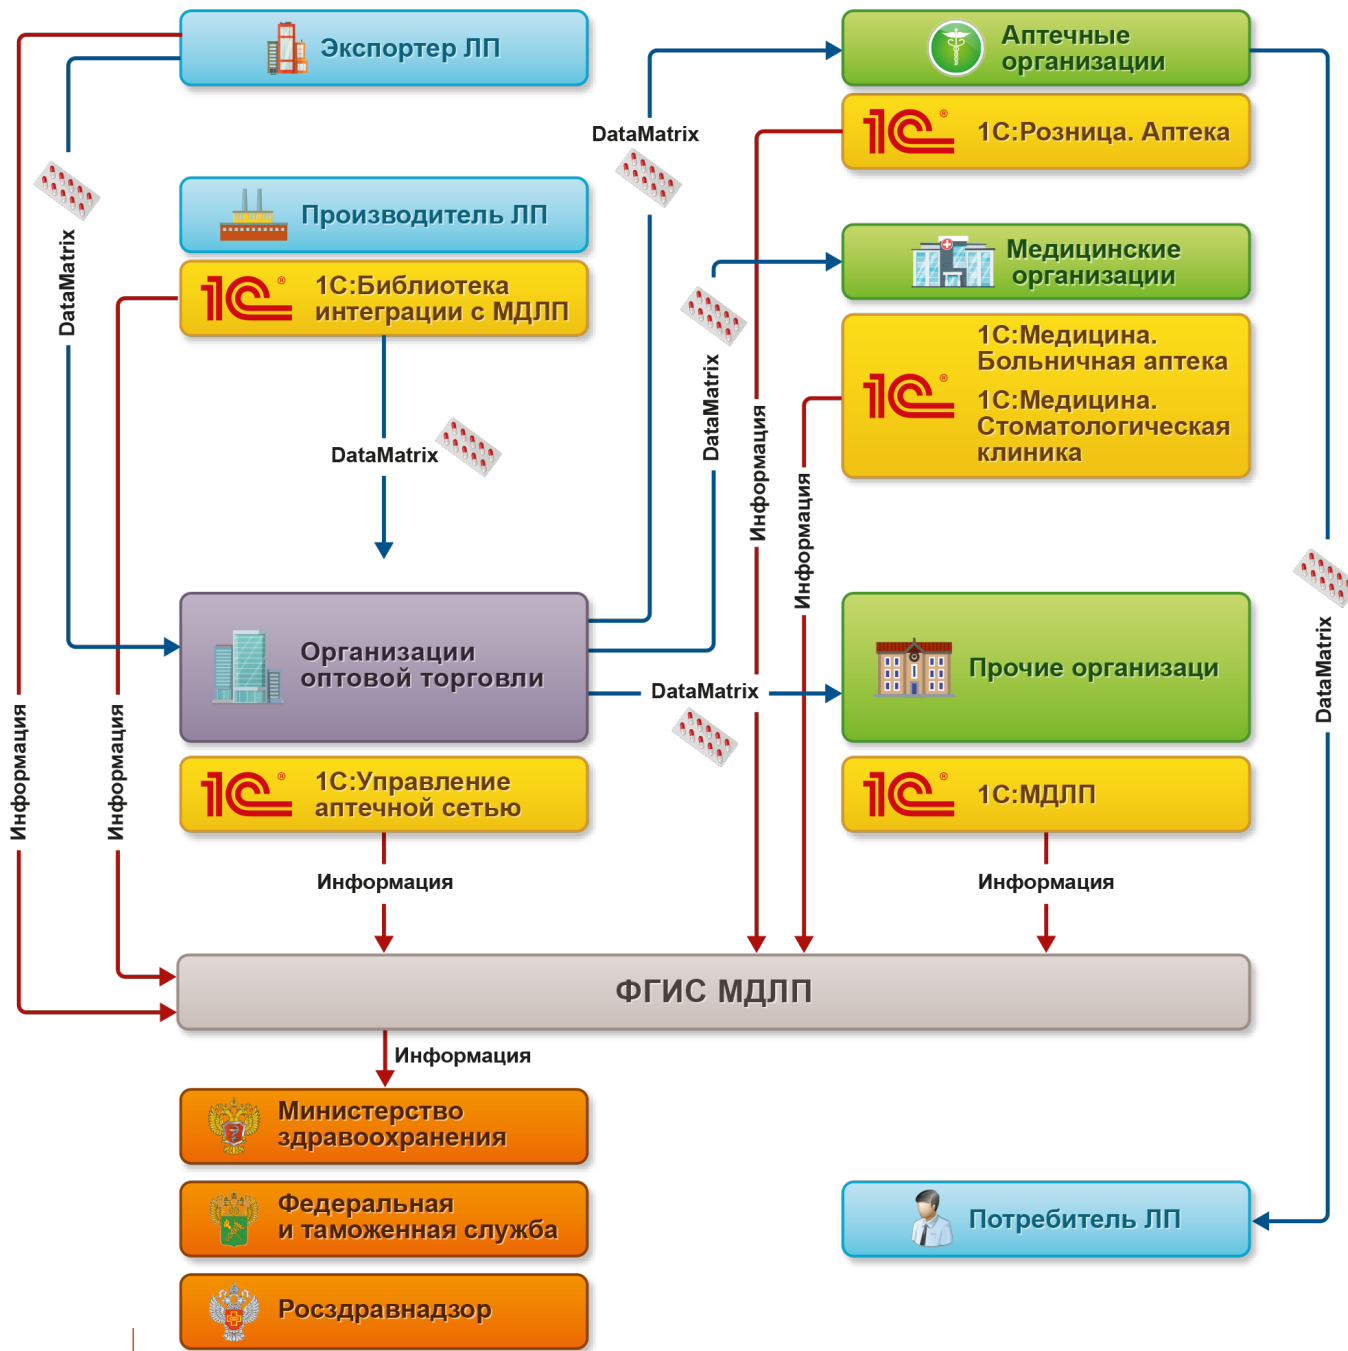

# 1С:Библиотека интеграции с МДЛП

## Библиотека может быть встроена:

- В отраслевые решения на платформе 1С:Предприятия силами партнерской сети 1С
- В решения на базе 1С:Предприятие силами ИТ-службы компании

## Линия консультаций фирмы «1С» по библиотеке:

- В системе 1С-Коннект — ЛК 1С:МДЛП Поддержка клиентов
- По телефону +7 (495) 956-11-81
- По электронной почте — [med@1c.ru](mailto:med@1c.ru)

## Порядок использования ознакомительной версии библиотеки:

- для разработки прикладных решений необходима подписка ИТС ПРОФ
- для использования прикладных решений с библиотекой необходима подписка ИТС



# Поддержка регистраторов выбытия

Обмен с регистраторами выбытия, подключенными в локальную вычислительную сеть организации, выполняется из **тонкого клиента** платформы 1С:Предприятие

- Информация о выводе лекарственных препаратов, отправленная через регистратор выбытия, находящегося в автономном режиме, поступает непосредственно во ФГИС МДЛП
- Приложение получает подтверждение о выводе препаратов от ФГИС МДЛП
- протестирована работа с:
  - Атол
  - Штрих-М



# Оборудование для считывания средств идентификации



05995327112039  
mNLOtgTtBmR3x  
test230819  
220823

Считывание средств идентификации лекарственного препарата (двумерных штрихкодов) требуется в двух случаях:


- при регистрации приемки товаров
- при регистрации вывода лекарственных препаратов из оборота непосредственно в подразделениях (отделениях) медицинской организации

Для считывания штрихкодов Data Matrix применяется оборудование и имеющее поддержку в **"1С:Библиотека подключаемого оборудования"**:

- штрихкод сканеры - [v8.1c.ru/common/skaner.htm](http://v8.1c.ru/common/skaner.htm)
- терминалы сбора данных (ТСД) - [v8.1c.ru/common/tsd.htm](http://v8.1c.ru/common/tsd.htm)
- драйвер ТСД должен соответствовать "Требованиям к разработке драйверов подключаемого оборудования" **версии 2.5** и выше



# 1С:Подпись



- Для подключения к личному кабинету [ЧестныйЗнак.РФ](https://www.chestnyy-znak.ru/) необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), оформленная на руководителя организации
- В качестве квалифицированного сертификата электронной подписи организации рекомендуем использовать сертификат, полученный с помощью 1С:Подпись
- Поддерживается работа с криптопровайдерами:
  - ViPNet CSP
  - КриптоПро CSP



# 1С:МДЛП в облачном сервисе 1cfresh.com



Поддерживаются следующие операции:

- отгрузка и приемка товаров;
- расформирование транспортной упаковки;
- внутреннее перемещение лекарственных препаратов;
- выдачи товара по льготному рецепту;
- передача лекарственных препаратов на уничтожение;
- выдача товаров для оказания медицинской помощи.

Поддержка:

- регистраторов выбытия
- сканеров-штрихкодов
- терминалов сбора данных

Приложение будет доступно по адресу – [mdlp.1c.ru](https://mdlp.1c.ru)





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



Приложение «1С:МДЛП» предназначено для организаций с небольшим оборотом лекарственных препаратов без ведения автоматизированного складского учета «1С:МДЛП» – это приложение для подключения к Федеральной государственной информационной системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов для медицинского применения» (ФГИС МДЛП).

### Попробовать 1С:МДЛП

 Я принимаю условия [оферты](#)

С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом 61-ФЗ «Об обороте лекарственных средств» в редакции от 28.12.2017 все участники оборота лекарственных препаратов для медицинского применения при производстве, ввозе в РФ, отпуске, реализации, передаче, применении и уничтожении лекарственных препаратов обязаны вносить информацию во ФГИС МДЛП. Порядок подключения к системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения описан на странице [«Маркировка лекарств»](#) сайта [ЧестныйЗНАК.РФ](#).

- штрихкод-сканеры;
- терминалы сбора данных (ТСД).

Драйвер ТСД должен соответствовать «Требованиям к разработке драйверов подключаемого оборудования» версии 2.5 и выше.

Рекомендуемое оборудование:

- Сканер штрихкода 1С 2200 2D;
- ТСД Urovo i6300 2D;
- ТСД Urovo i6200 2D.



# Анонс релизов с поддержкой регистраторов выбытия

- «1С:Библиотека интеграции с МДЛП» релиз 1.1.2 вышел до 26 сентября 2019 г.
- «1С:Медицина. Больничная аптека» релиз 2.1.5 выйдет до 4 октября 2019 г.





**1С:ИТС**  
**[www.its.1c.ru](http://www.its.1c.ru)**

27 сентября 2019 г. Москва

**Спасибо за внимание!**